

精準醫學核心實驗室檢驗資訊表


更新日期：2023 年 11 月 04 日

PM.QP004-01

檢驗項目名稱	次世代定序泌尿上皮癌基因檢測	計價碼	14998-03
檢體種類	石蠟包埋組織	檢體量	5 μ m 七片
採檢適用容器	檢體為石蠟包埋組織，由實驗室人員自行調閱。		
禁食限制	無	加作檢驗	不適用
採檢注意事項	1. 每片檢體的表面積至少達到 5x5mm。 2. 每片檢體至少有 30%以上的腫瘤含量。		
輸送條件	1. 永康院區內：無 2. 非永康院區：無		
檢驗儀器	Illumina® NovaSeq 6000 System、5300 Fragment Analyzer System		
檢驗方法	次世代定序(Next Generation Sequencing, NGS)		
檢驗試劑	FusionPlex® Reagents for Illumina		
報告完成時間	收到合格檢體後 14 個工作天		
生物參考區間	Not detected	危險臨界值	無
臨床意義	針對泌尿上皮癌症組織檢體進行 17 個融合基因檢測，協助醫師掌握病患病情，為病患找出更多的治療選擇。		
干擾因素	1. RNA 品質不佳會影響文庫定量的濃度。 2. 組織採檢 5 年以上，可能因 deamination 導致偽陽性結果，也可能因核酸片段碎裂導致偽陰性結果。 3. 骨頭組織應使用 EDTA 脫鈣，應避免使用酸性溶液，導致 RNA 品質以及濃度過低。		
操作組別/分機	精準醫學核心實驗室/52619		
委外代檢	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 委外代檢 代檢機構：_____ 聯絡電話：_____ 地址：_____		

備註	<p>1. 檢測限制： 腫瘤組織的百分比過低時，實驗室會使用 macrodissection 增加腫瘤佔比，組織若仍小於 10%(LOD)且無其他替代檢體可使用，因有偽陰性之可能，若檢測後為 Not detected，報告內容會加註：「因腫瘤百分比極少，有偽陰性之可能，或可用靈敏度更高之檢測工具檢測」。</p> <p>2. 結果判讀：上傳至 Archer Perform Analysis 進行資料分析。</p>
----	--

Archer Lung Panel 基因檢測

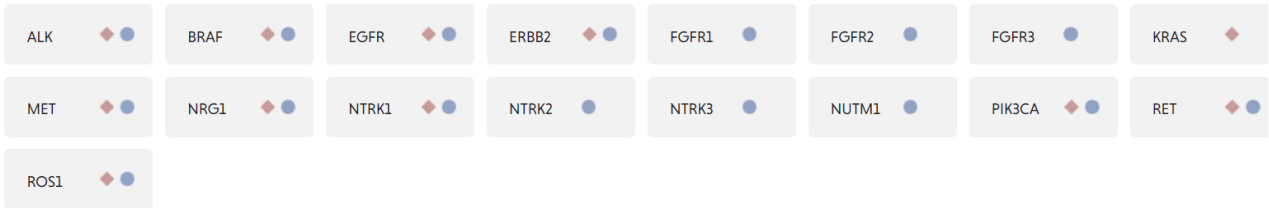

LEGEND

- ◆ SNV/Indel
- Fusion, splicing or exon-skipping